

Pour installer :



(1.) Placez l'extrémité inférieure du pied de support au pied de l'articulateur.



(2.) Tournez le pied de support vers le haut pour encastrer ou fixer le support vertical de l'articulateur.

Pour retirer :




(3.) Placez les pouces sur les clips de fixation.




(4.) Poussez les clips vers le côté puis vers l'arrière pour retirer.

Pour utiliser :

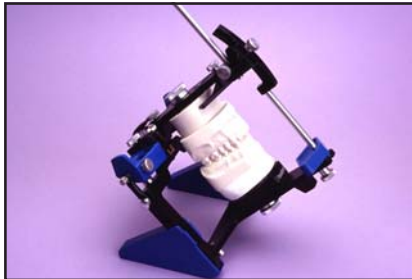

(5.) Les pieds supporteront l'articulateur incliné à 45° vers l'arrière pour les consultations du patient et les procédures de photographie.

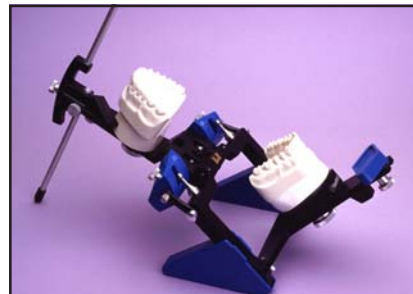

(6.) Ouvrez l'arrière du cadre supérieur pour qu'il soit supporté par la broche de support afin de faciliter les procédures de laboratoire.

Pour installer :

REF 2094



(1.) Placez l'extrémité inférieure du pied de support au pied de l'articulateur.



(2.) Tournez le pied de support vers le haut pour encastrer ou fixer le support vertical de l'articulateur.

Pour retirer :




(3.) Placez les pouces sur les clips de fixation.




(4.) Poussez les clips vers le côté puis vers l'arrière pour retirer.

Pour utiliser :

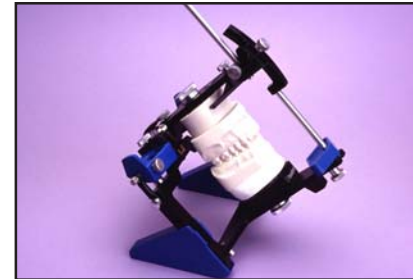

(5.) Les pieds supporteront l'articulateur incliné à 45° vers l'arrière pour les consultations du patient et les procédures de photographie.

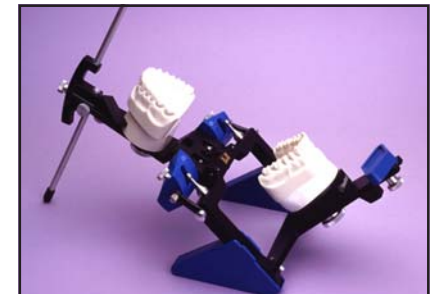

(6.) Ouvrez l'arrière du cadre supérieur pour qu'il soit supporté par la broche de support afin de faciliter les procédures de laboratoire.